



## Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.

22-400 Zamość, ul. Peowiaków 1  
tel. 084 677-50-00, fax 084 638-51-45  
www.szpital.com.pl e-mail: zamosc@szpital.com.pl



Zamość 2012-05-14

### Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 11 /PN/12 na „ Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku”**

#### WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. w Zamościu , działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759), w związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, poniżej podaje treść pytań i odpowiedzi:

Pytanie 1 Zadanie nr 1:

**Poz.1-4:** Prosimy o sprecyzowanie czy strzykawkki mają posiadać skalę nadrukowaną na cylindrze odpowiadającą pojemności nominalnej strzykawkki?

**Odpowiedź: TAK.**

Pytanie 2 Zadanie nr 1

**Poz.5,6 i 8:** Prosimy o wyjaśnienia czy strzykawkki mają posiadać oryginalnie nadrukowane logo producenta i typ strzykawkki na cylindrze, co pozwala na identyfikację strzykawkki bez opakowania jednostkowego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Pytanie 3 Zadanie nr 1

**Poz.10-15:** Prosimy o sprecyzowanie czy igły iniekcyjne mają być polerowane elektrochemicznie co pozwala na usunięcie wszelkich metalowych opiłków, chropowatość i innych niedoskonałości powstających przy ostrzeniu końcówki igły w celu uzyskania idealnie gładkiej powierzchni?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Pytanie 4 Zadanie 3, poz. 12-16:

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie ww. pozycji i utworzenie odrębnego zadania np. 3A. Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty a Zamawiającemu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

Pytanie 5 Zadanie nr 5:

**Poz.3:** Prosimy o sprecyzowanie czy worek do dobowej zbiórki moczu ma być wyposażony w port do pobierania próbek? Umożliwia to nierozłącznie zamkniętego systemu jaki stanowi worek na mocz połączony z cewnikiem Foleya, co zapobiega wzrostowi ryzyka wprowadzenia infekcji do układu moczowego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Pytanie 6 Zadanie nr 5

**Poz.10,11, 15:** Prosimy o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.**

Pytanie 7 Zadanie nr 5

**Poz.12:** Prosimy o dopuszczenie zaoferowania drenu do odsysania pola operacyjnego o średnicy wewnętrznej 5,6 oraz zewnętrznej 8,0mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na dren o średnicy wewnętrznej 5,6mm, ponieważ taka średnica nie gwarantuje drożności drenu. Zmniejsza się skuteczność odsysania i może nastąpić zatkanie drenu przez skrzepy krwi.

**Pytanie 8 Zadanie nr 6:**

**Poz.3 i 4:** Czy cewniki do odsysania mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru na opakowaniu ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie 9 Zadanie nr 11:**

**Poz.1:** Prosimy o dopuszczenie zaoferowania kaniuli dożylniej bez portu bocznego producenta – firmy Becton Dickinson wykonanej z podwójnie oczyszczonego teflonu, widocznej w aparacie usg, wyposażonej w dodatkowy zdejmowalny element ułatwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 10 Zadanie nr 11:**

**Poz.1-7:** Prosimy o sprecyzowanie czy kaniule dożylnie mają posiadać wskaźnik wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej zabezpieczającej przed wypływem krwi w momencie wklucia?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie 11 Zadanie nr 11:**

**Poz.3-7:** Prosimy o sprecyzowanie czy pod pojęciem „ badania potwierdzające biokompatybilność kaniul wykonanych z poliuretanu” Zamawiający oczekuje dołączenia min. 3 badań klinicznych potwierdzających ograniczenie występowanie zakrzepowego zapalenia żył związanych z materiałem zastosowanym do produkcji kaniul?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie 12 Zadanie nr 11:**

**Poz.2-7:** Prosimy o dopuszczenie zaoferowania kaniul dożylnych wyposażonych w min.4 paski rtg, pozwalające na kontrolę położenia cewnika?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza kaniule dożylnie wyposażone w min.4 paski rtg.

**Pytanie 13 Zadanie nr 13:**

**Poz.2:**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania igły do znieczuleń w rozm. 23G x 90mm lub 25G x 90mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

**Pytanie 14 Zadanie nr 13**

Prosimy o sprecyzowanie czy igły mają być pakowane w opakowanie Tyvec? Opakowanie takie poprzez swoją wielowarstwową strukturę zabezpiecza przed mikrouszkodzeniami spowodowanymi zewnętrznymi czynnikami mechanicznymi w trakcie użytkowania, przechowywania oraz transportu?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

**Pytanie 15 Zadanie nr 17:**

**Poz.1 i 2:** Prosimy o wyjaśnienie czy rurki intubacyjne mają posiadać mleczny zdejmowalny łącznik?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie 16 Zadanie nr 17**

**Poz.2:** Prosimy o sprecyzowanie czy rurki intubacyjne mają posiadać wskaźnik głębokości widoczny pod kontrolą laryngoskopu w postaci jednego grubego ringu wokół całego obwodu rurki, co pozwala na kontrolę głębokości położenia rurki?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie 17 Zadanie nr 18:**

**Poz.1-3:** Prosimy o sprecyzowanie czy filtry oddechowe mają posiadać oryginalnie podane przez producenta na obwodzie filtra wartości minimalne i maksymalne objętości oddechowej Vt?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 18 Dotyczy zapisów siwz:**

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający w przypadku wątpliwości będzie żądał dostarczenia próbek w celu weryfikacji czy zaoferowane produkty odpowiadają wymogom Zamawiającego zawartym w SIWZ?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 19 Dotyczy zapisów siwz**

Prosimy o sprecyzowanie czy w celu potwierdzenia spełnienia przez zaoferowany asortyment opisu przedmiotu Zamówienia, Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty katalogów oraz dokumentów dopuszczających zaproponowany asortyment do obrotu na terenie Polski?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 20**

**Dotyczy Pakietu 18 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści filtr mikrobiologicznie czysty?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 21**

**Dotyczy Pakietu 18 poz 2.**

Czy Zamawiający dopuści filtr mikrobiologicznie czysty o czasie stosowania 24h?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie 22**

**Dotyczy Pakietu 18 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści filtr mikrobiologicznie czysty?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 23**

**Pytania dotyczące treści SIWZ:**

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupu jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka). **(Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06)**

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 24**

**Pytania dotyczące projektu umowy:**

**Pytanie nr 1 dotyczy §1 ust.3 pkt. 1**

Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 25** dotyczy §4 ust.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na **wydlużenie terminu dostawy z 4 do 6 dni roboczych** od dnia wpłynięcia zamówienia cząstkowego.

Prośbę motywujemy faktem, iż dostarczany asortyment nie posiada bardzo krótkiego terminu ważności, przez co Zamawiający jest w stanie wcześniej określić wielkość zapotrzebowania i może wcześniej złożyć zamówienie, dzięki czemu Wykonawca będzie mógł terminowo zrealizować dostawę. Poza tym termin dostawy wynoszący 4 dni jest nierealny, w przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług wynajętego przewoźnika. Zamówienie, które wpływa do wykonawcy jednego dnia najwcześniej

może być zarejestrowane w dniu następnym, pod warunkiem, że będzie zawierało wszystkie niezbędne dane do prawidłowej realizacji zamówienia zgodnie z warunkami umowy. Wystawienie stosownych dokumentów WZ, spakowanie towaru następuje najczęściej trzeciego dnia po otrzymaniu zamówienia. Spedytor dostarcza towar w ciągu 48 godzin (kolejne dwa dni), a zatem termin 5 dni roboczych jest terminem minimalnym na zrealizowanie zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 26 dotyczy §6 ust.1 pkt. a**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej z „w wysokości 0,2% wartości brutto nie dostarczonego towaru” na „w wysokości 0,1% wartości netto nie dostarczonego towaru”?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia:**

**Pytanie 27 dotyczy zadania nr 16**

Czy Zamawiający życzy sobie zaproponowania pojemników w kolorze czerwonym z nalepką?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie 28 dotyczy zadania nr 16**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenienie tj. podanie ceny jednostkowej i wartości osobno dla pojemników i osobno dla nalepek. Prośbę motywujemy tym, iż w naszym systemie zarządzającym sprzedają pojemnik i nalepka stanowią odrębną pozycję asortymentową, mają swoje numery katalogowe i ceny sprzedaży.

Powyższe oczywiście nie oznacza, iż produkty te nie są ze sobą kompatybilne i mogą być przez Zamawiającego traktowane i używane jako zestaw produktów.

**Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.**

**Pytanie 29**

**Dotyczy Zadanie nr 12 poz.1-6**

Czy w zadaniu nr 12, poz. 1-6 zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękawy o parametrach zgodnych z normą PN EN 868-3 oraz 868-5 o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>

Gramatura oraz wszelkie parametry techniczne oferowanych przez naszą firmę produktów zostały dobrane optymalnie, zapewniając odpowiednią wytrzymałość na rozerwanie i przepuklinie. Nasze rękawy posiadają folię 6-warstwową, a dzięki specjalnej charakterystyce papieru, opakowanie nie jest przepuszczalne i stanowi doskonałą barierę dla bakterii oraz gwarantuje bezpieczną sterylizację i przechowywanie materiałów medycznych.

**Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.**

**Pytanie 30**

**Dotyczy Zadanie nr 12 poz.5**

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na rękawy szerokości 210mm zamiast 200mm?

Różnica 10mm na korzyść zamawiającego umożliwi nam złożenie atrakcyjnej cenowo oferty.

**Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.**

**Pytanie 31**

Dotyczy Zadanie nr 12 poz.7-12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na papier krepowany o gramaturze 60g/m<sup>2</sup> i parametrach zgodnych z normą PN EN 868-2?

**Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.**

**Pytanie 32**

Dotyczy Zadanie nr 12 poz.7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na papier krepowany w rozmiarze 45x45cm?

**Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.**

**Pytanie 33**

Dotyczy Zadanie nr 12 poz.16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na wieloparametrowe wskaźniki chemiczne do pary wodnej pakowane a 500 szt. w opakowaniu jednostkowym ?

**Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.**

**Pytanie 34**Zadanie nr 3 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec w rozmiarze 100 x 160cm?

**Odpowiedź: Nie dopuszczamy.****Pytanie 35**Zadanie nr 3 poz. 16

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie ze SIWZ.****Pytanie 36**Zadanie nr 4 poz.1

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet w składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta o wym. 170x180cm

Serweta samoprzylepna, dolna z łąką chłonna o wym. 50x80cm i pojedynczym organizerem na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny, z łąką chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 50x80cm. Łąka chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Serweta o wym. 170 x 240cm

Serweta samoprzylepna, górna, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łąką chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 30x80cm i pojedynczym organizerem na przewody. Łąka chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

2 x Serweta samoprzylepna 2-warstwowa o wym. 70 x 90cm

Serweta 2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.****Pytanie 37** Zadanie nr 4 poz.2

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet w składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 90 x 120cm

2 warstwowa, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

2 x Nogawica o wym. 70x120cm

Wykonana z włókniny z podwójnie wywiniętym brzegiem

1x Serweta urologiczo-ginek o wym.75 x 200cm

2 warstwowa z otworem w kształcie rombu o wym. 8x12cm, długość boku rombu 7cm, w bocznych częściach serwety wycięcia w kształcie półkola o promieniu 15cm Gramatura serwety 56 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

4 x Ręcznik do rąk 30x30cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie 38** Zadanie nr 4 poz.2

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet w składzie:

1 x Serweta na stolik o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 -warstwowa , laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu Gramatura serwety 56 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

2 x Nogawica o wym. 70x120cm

Nogawica wykonana z włókniny, z podwójnie wywiniętym brzegiem

1 x Serweta operacyjna o wym. 170 x 180cm

Serweta z przylepcem wykonana z włókniny

1 x Serweta operacyjna o wym. 75 x 100cm

Serweta 2- warstwowa samoprzylepna z otworem 6 x 14cm na narządy płciowe. Gramatura serwety 56 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Taśma przylepna 10 x 50cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie 39**

Zadanie nr 4 poz.3

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet w składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta do artroskopii o wym. 200 x 320cm

Serweta z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6 x 8cm. Serweta wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łąką chłonna/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. min. 75 x50cm i 2oma organizerami na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Torebka na płyny o wym. 60 x 100cm

Torebka z przezroczystego polietylenu, z otworem samouszczelniającym się o wym. 6x8cm, z kształtką metalową w górnej części torebki na całej jej górnej krawędzi, z 2ma przylepcami w przedniej części służące do ufixsowania torebki, portem do odsysania treści w dolnej części worka, budowa końcówki portu umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy.

1 x Pokrowiec na przewody Comfort o wym. 14 x 250cm.

Pokrowiec z przezroczystego polietylenu , składany teleskopowo, z przylepcem

1 x Nogawica o wym. 30 x 60cm

Nogawica 2 - warstwowa. Gramatura 56 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

2 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

2x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do

wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 40**

Zadanie nr 4 poz.4

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet w składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta z wycięciem U o wym. 200 x 260cm

Serweta z wycięciem U samoprzylepnym o wym. 8,5 x 85 cm, z łata chłonna o wym. 80x30cm i 2oma organizerami na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Serweta o wym. 170 x 300cm

Serweta samoprzylepna z łata chłonna o wym. 80x30cm i pojedynczym organizerem na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu.

Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Serweta o wym. 170 x 180cm

Serweta z włókniny, samoprzylepna

1 x Nogawica o wym 35 x 120 cm

Nogawica 2 - warstwowa. Gramatura 56 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

2 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 41**

Zadanie nr 5 poz.10-11

Czy Zamawiający dopuści zestawy ze strzykawką 5 ml spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź: TAK**

#### **Pytanie 42** Zadanie nr 5 poz. 15

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie ze SIWZ.**

#### **Pytanie 43** Zadanie nr 7 poz.4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a, 75szt.?

**Odpowiedź: Tak, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.**

#### **Pytanie 44** Zadanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści kaniule z 3 paskami kontrastującymi?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie ze SIWZ.**

#### **Pytanie 45** Zadanie nr 11

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu badań na potwierdzenie biokompatybilności?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie ze SIWZ.**

**Pytanie 46 Zadanie nr 4****Poz. 1** : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu w składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy 140x190 cm
  - 1 serweta na stół Mayo 80 x 145 cm
  - 1 serweta samoprzylepna (głowa) 150x240 cm
  - 1 serweta samoprzylepna (nogi) 170x175 cm
  - 2 serwety samoprzylepne 75x90 cm
  - 1 taśma samoprzylepna 10x50 cm
  - 2 ręczniki celulozowe 33x33 cm
- z kieszenią samoprzylepną pakowaną oddzielnie?  
Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

**Pytanie 47 Zadanie nr 4****Poz. 2** – Czy można zaferować zestaw o następującym składzie i rozmiarach :

	<b>Zestaw do ginekologii</b>	<b>6 zestawów</b>	<b>938727</b>	
	<b>Skład zestawu:</b>			
	1 serweta na stół narzędziowy	100 x 150		
	1 serweta z samoprzylepnym oknem (7 x 10 cm)	200 x 100		
	2 osłony na kończynę długie	120 x 75		
	2 ręczniki celulozowe	33 x 33		


**Odpowiedź: NIE****Pytanie 48 Zadanie nr 4****Poz. 3** – Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na zestaw serwet do artroskopii kolana o następującym składzie i rozmiarach :

	<b>Zestaw do artroskopii I</b>		<b>4 zestawy</b>	<b>938703</b>	<b>1</b>
	<b>Skład zestawu:</b>				
	1 serweta na stół narzędziowy	140 x 190			
	1 obłożenie stolika Mayo	80 x 145			
	1 serweta pomocnicza	150 x 150			
	1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów	320 x 200			
	1 osłona na kończynę	25 x 80			
	2 taśmy samoprzylepne	10 x 50			
2 ręczniki celulozowe	33 x 33				

z osłonami na przewody pakowanymi oddzielnie ?

**Odpowiedź: TAK.****Pytanie 49 Zadanie nr 4****Poz. 4** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do operacji stawu biodrowego o następującym składzie i rozmiarach :

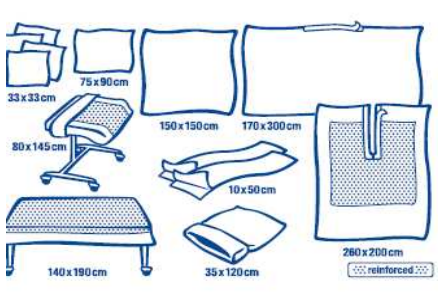

 <p><b>Zestaw do zabiegów w chirurgii biodra II</b></p> <p>Skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 serweta na stół narzędziowy</li> <li>1 obłóżenie stolika Mayo</li> <li>1 serweta samoprzylepna</li> <li>1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U”</li> <li>1 serweta nieprzylepna</li> <li>1 serweta nieprzylepna</li> <li>1 osłona na kończynę</li> <li>2 taśmy samoprzylepne</li> <li>4 ręczniki celulozowe</li> </ul>		3 zestawy	938701	1
--	--	-----------	--------	---

z kieszenią samoprzylepną pakowaną oddzielnie ?

**Odpowiedź: TAK**